



德州市产品质量标准计量研究院

DeZhou Institute of Product Quality Standard and Metrology

共 2 页 第 1 页

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 长 检字第 2404653 号
Certificate No.

送 检 单 位 德州联合石油科技股份有限公司

Name of customer

计 量 器 具 名 称 涂层测厚仪

Name of Instrument

型 号/ 规 格 DR260

Type size

出 厂 编 号 26739 (DTL0215003)

Serial No.

制 造 单 位 广东市东儒电子科技有限公司


Manufacturer

检 定 依 据 JJG 818-2018 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪

Verification Regulation

检 定 结 论 合格

Conclusion

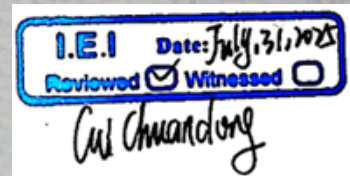

批准人

Approved by

(检定专用章)

核验员

Checked by

检定员

Verified by

检定日期 2024 年 8 月 20 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2025 年 8 月 19 日
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鲁) 法计 (2023) 37012 号

Authorization Certificate No. (2023)37012

地址: 山东省德州市长河大道 279 号

Address: No. 279 Changhe Road Dezhou Shandong

传真: 0534-8258180

Fax

电话: 0534-8258150

Tel

邮编: 253000

Postcode

电子邮件: dzjlsyb@126.com

EMAIL



扫描全能王 创建

德州市产品质量标准计量研究院

DeZhou Institute of Product Quality Standard and Metrology

共 2 页 第 2 页

证书编号: Certificate No. 长 检字第 2404653 号

本所是国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (鲁) 法计 (2023) 37012 号
This laboratory is a national legal metrological verification institution Authorization certificate: No(2023)37012.

本所出具的数据均可溯源至国家和国际计量基准。
All data issued by ZIMITT are traceable to national and international primary standards.

检定所使用的计量标准名称: 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定装置
Standard of measurement used in the verification

测量范围: Measurement range (0 ~ 1000) μm

不确定度或准确度等级或最大允许误差: $U=1.0\mu\text{m } k=2$
Uncertainty or accuracy class or maximum permissible error

计量标准证书号: [2020]德计标证字 015 号
Measurement standard certificate number

有效期至: Valid until 2024-09-10

检定的环境条件: Environmental condition in the verification 温度: Temperature 19.3 $^{\circ}\text{C}$ 湿度: Humidity 46 %RH

检定结果

Results of verification

序号	检定项目	技术要求	实测结果
1	外观及各部分相互作用	工作铭牌清晰, 外表无锈蚀, 各插件工作可靠	合格
2	测量力及其变动性	(0.3~1.5) N; 变动性不超过 1/3 F	合格
3	测量重复性	0.4 μm + 1% H	合格
4	示值误差	/	见下表

标准片厚度 (μm)	实测值 (μm)
23.1	22.6
50.5	49.2
124.6	127
250.4	253
490	496
985	978

备注: 设备未调整
以下空白

- 未经本单位书面批准, 不得部分复印此证书。
The certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.
- 本证书的检定结果仅对所检仪器有效。
The results are only responsible for the items verified.
- 本证书未加盖检定专用章无效。
The certificate is invalid without official stamp.



扫描全能王 创建